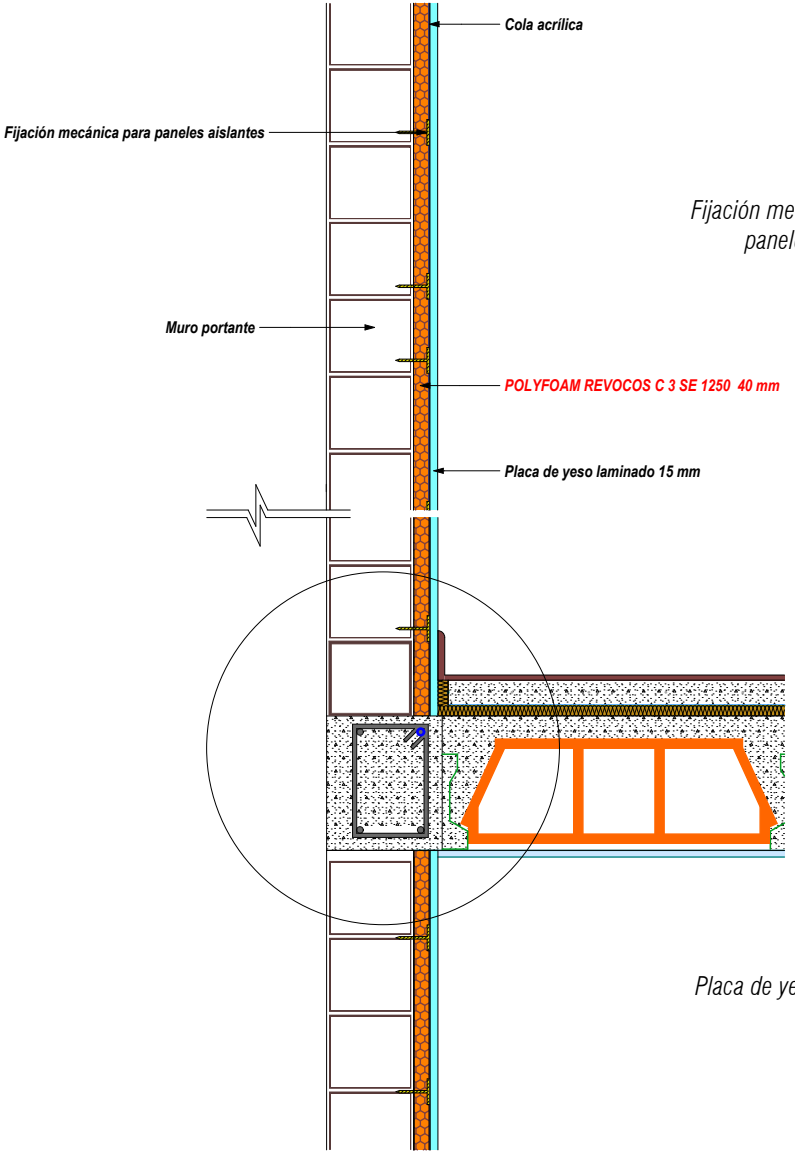

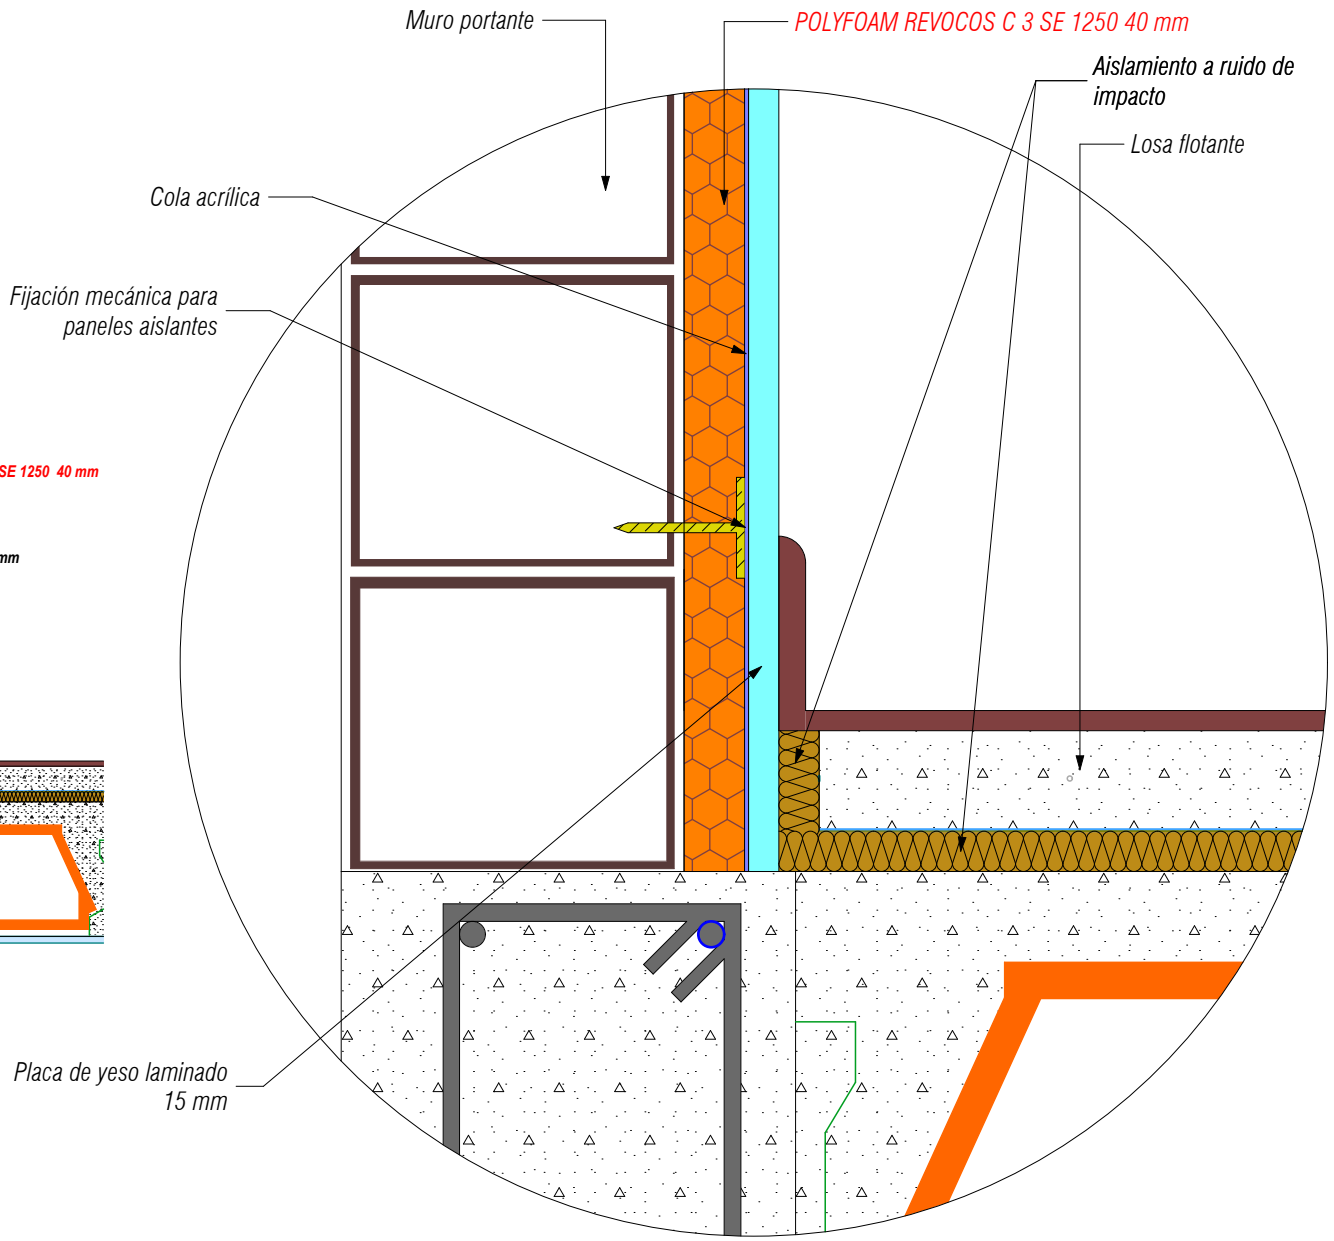

TRASDOSADO DIRECTO CON POLYFOAM REVOCOS